

Fig. 1

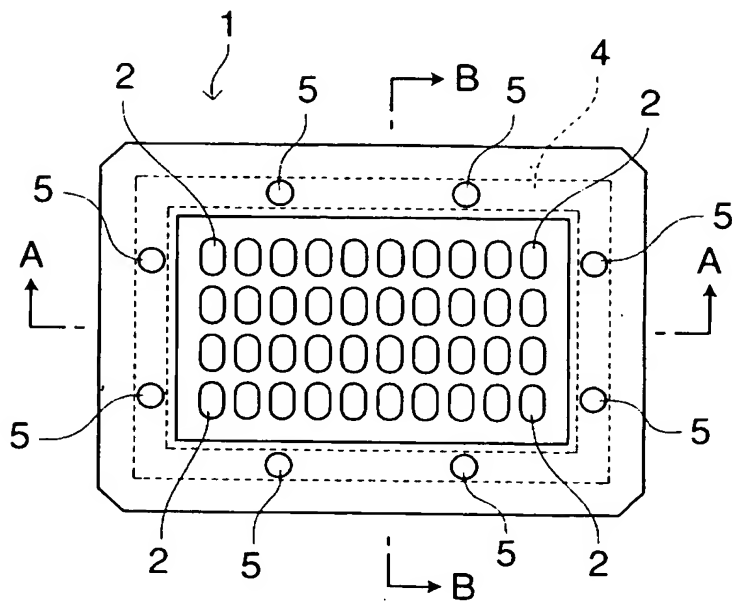


Fig. 2

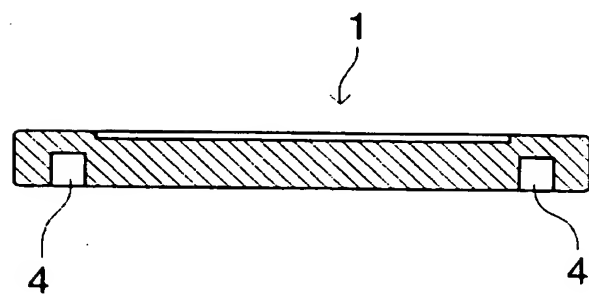


Fig. 3

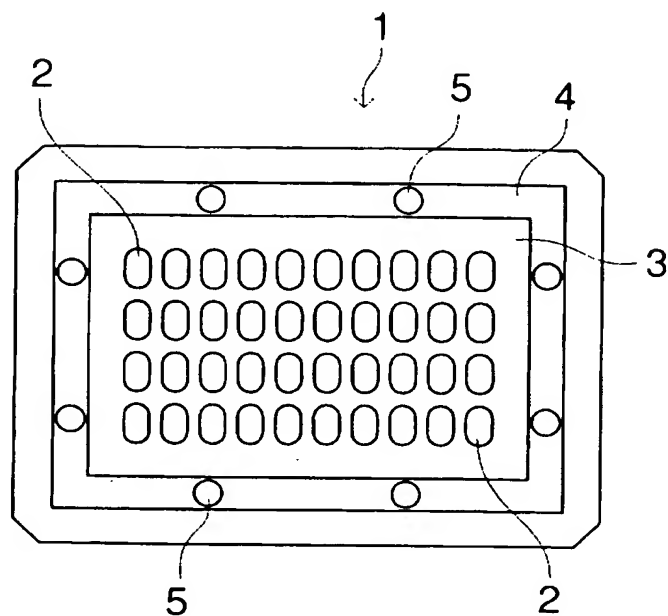


Fig. 4

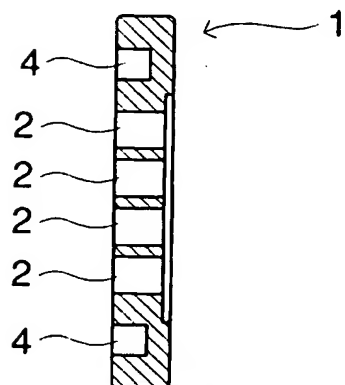


Fig. 5

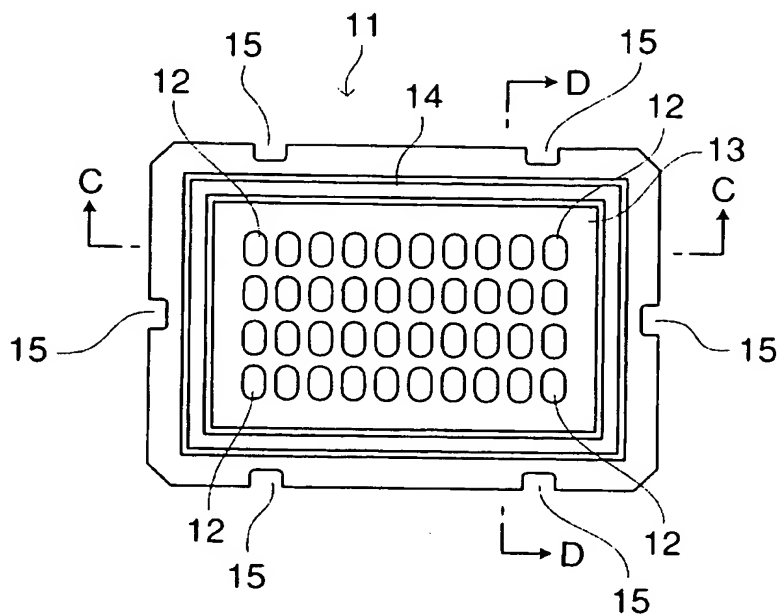


Fig. 6

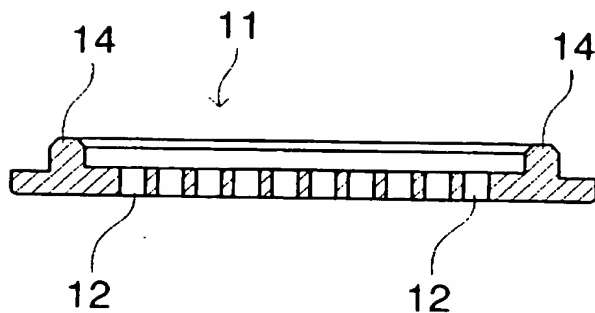


Fig. 7

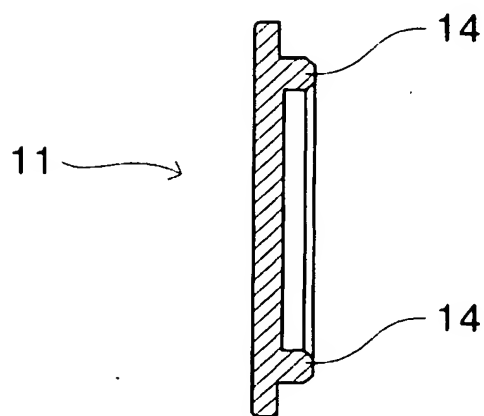


Fig. 8

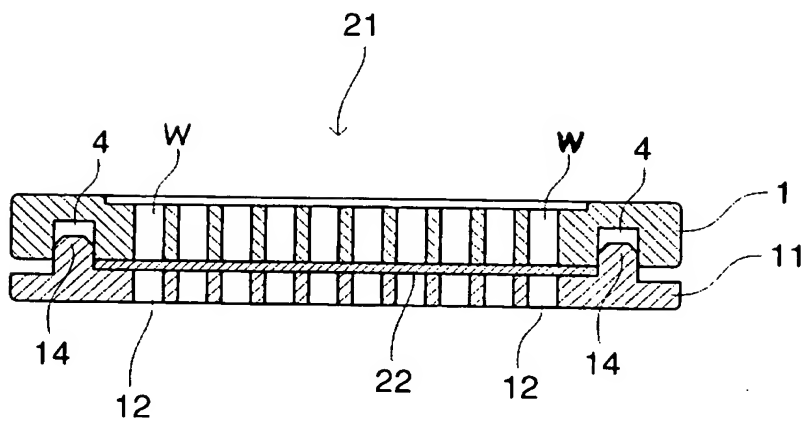


Fig. 9

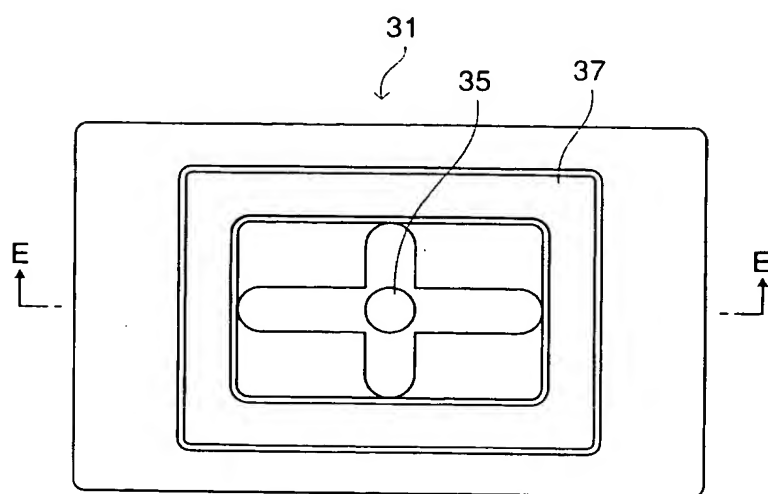


Fig. 10

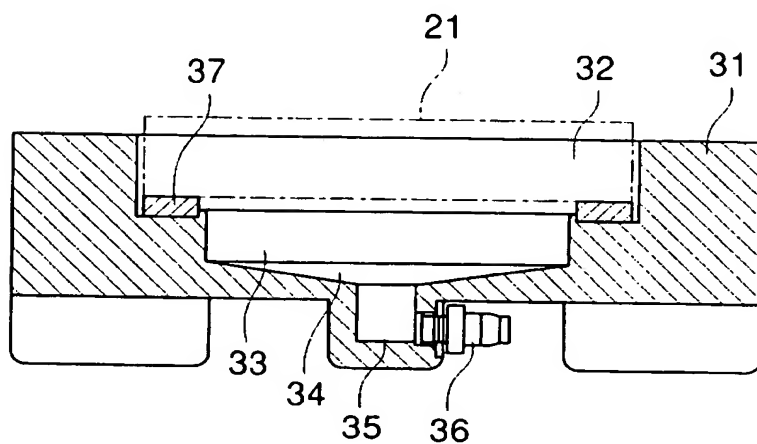


Fig. 11

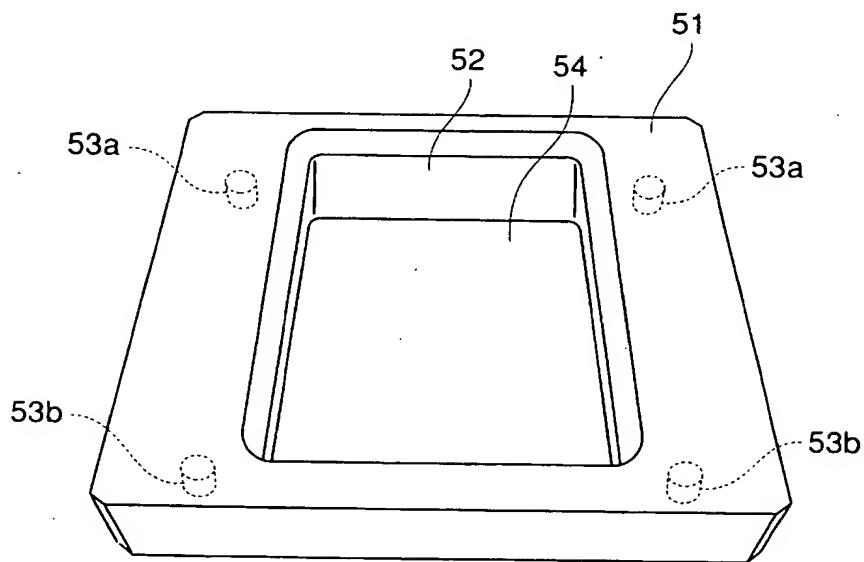


Fig. 12

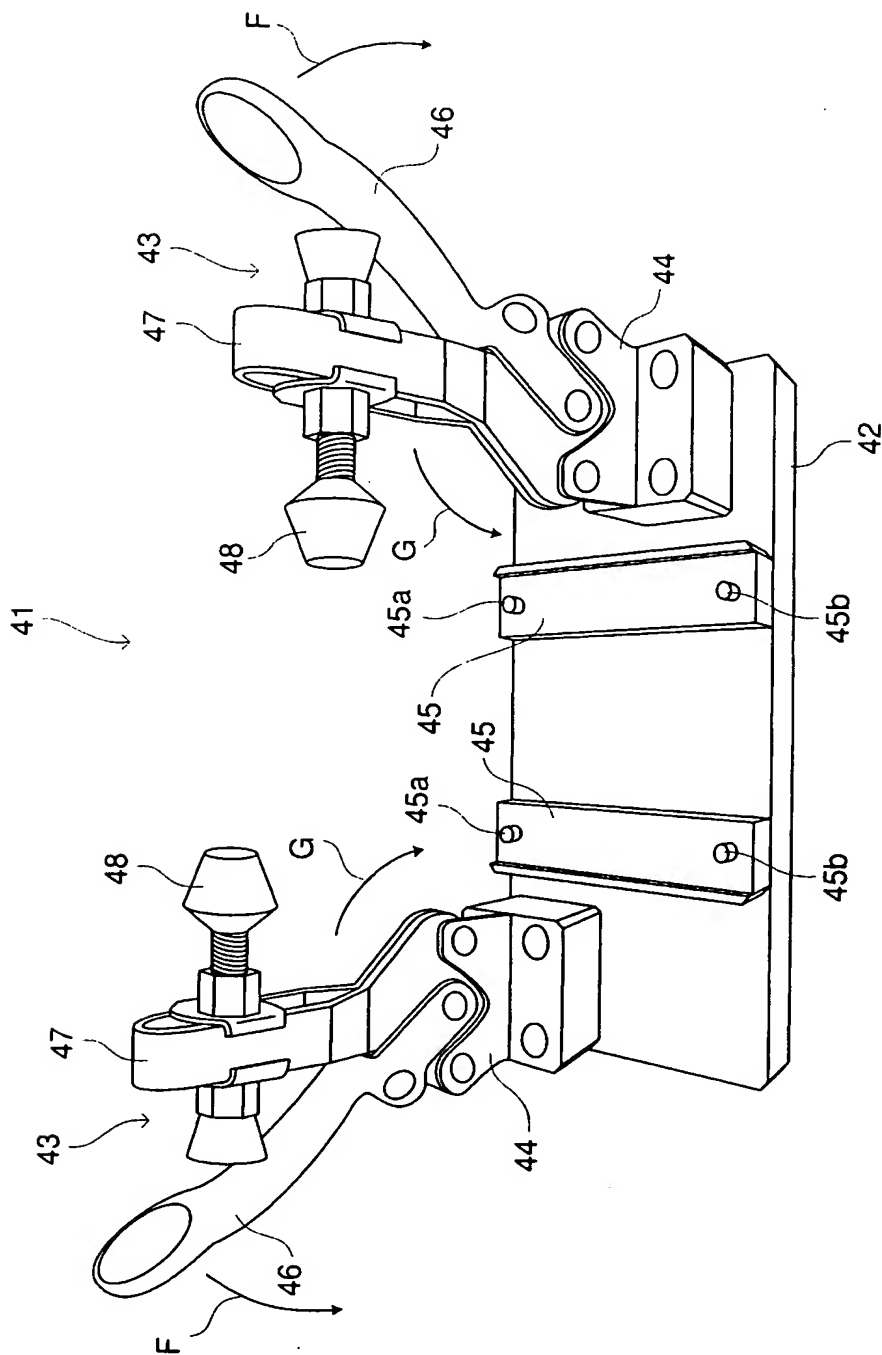


Fig. 13

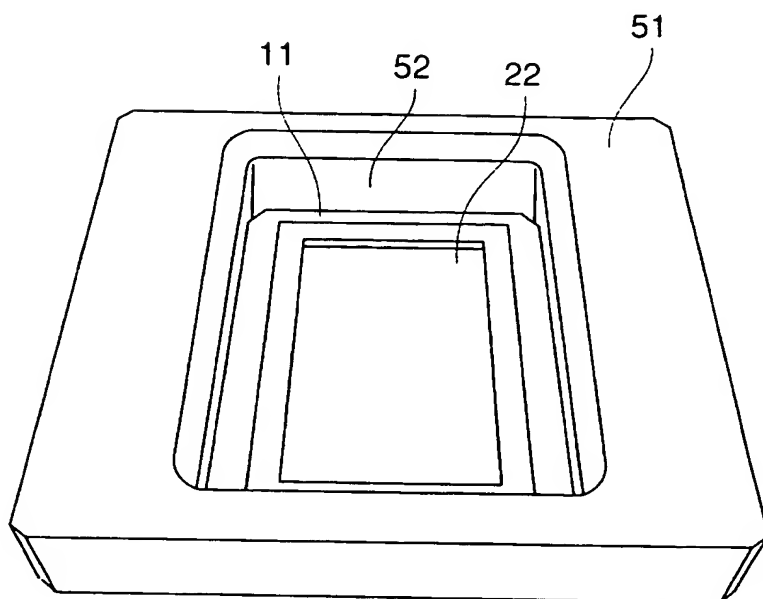


Fig. 14

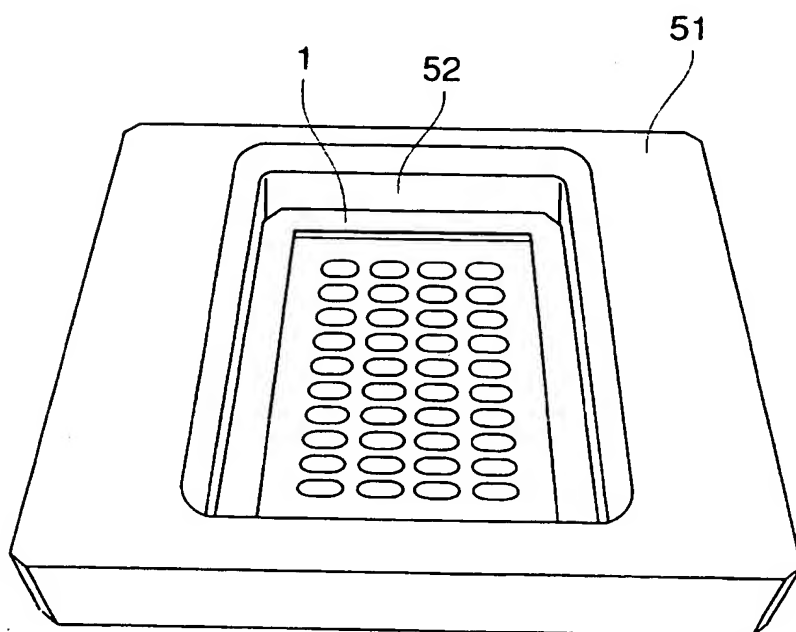




Fig. 15

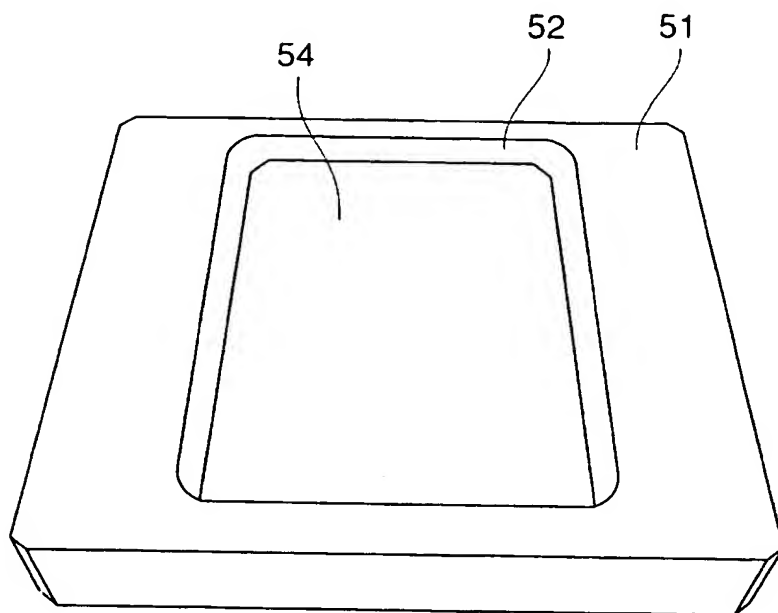


Fig. 16

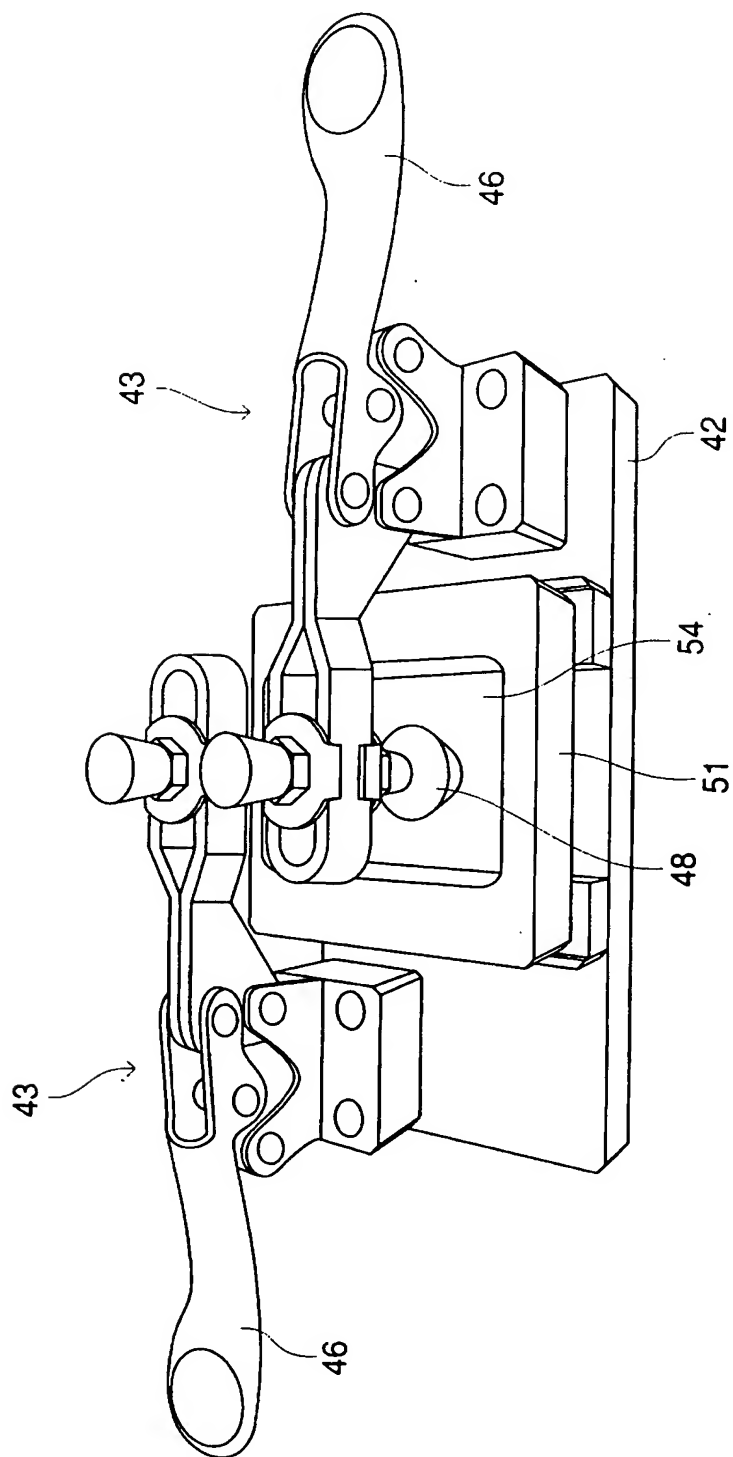


Fig. 17

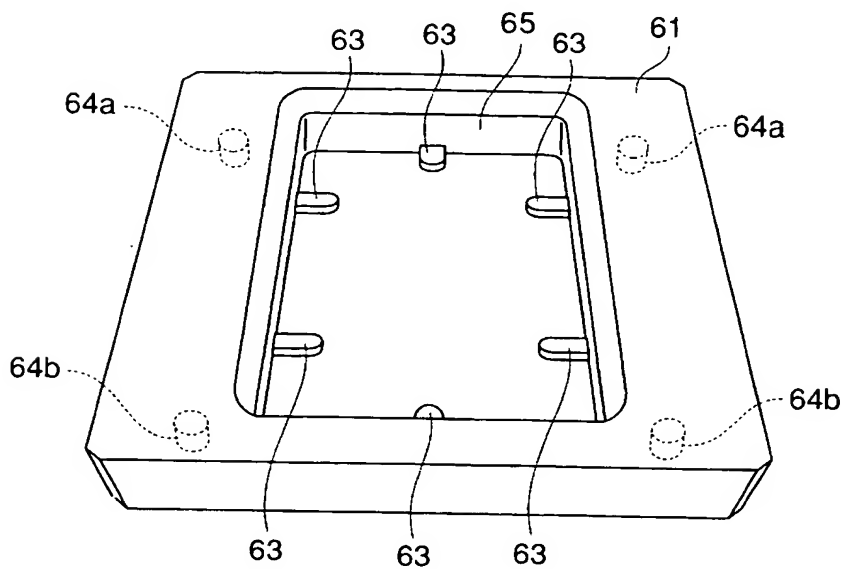


Fig. 18

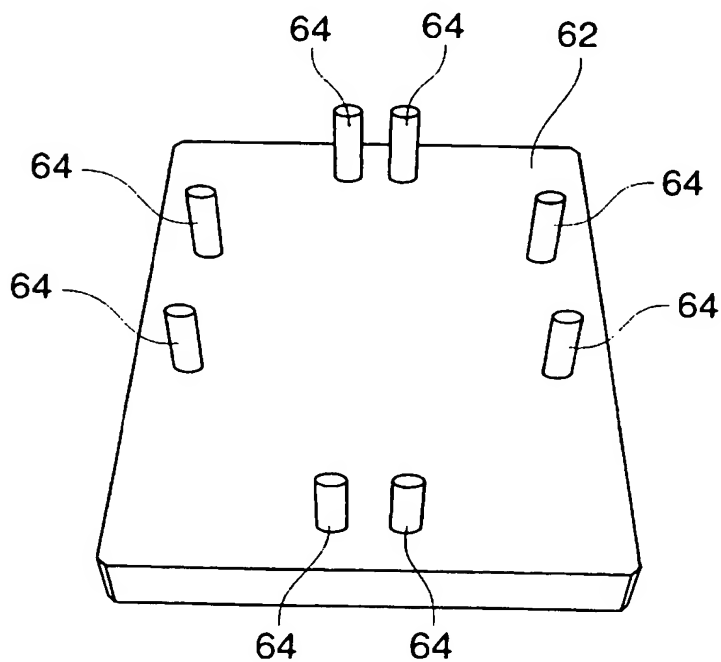


Fig. 19

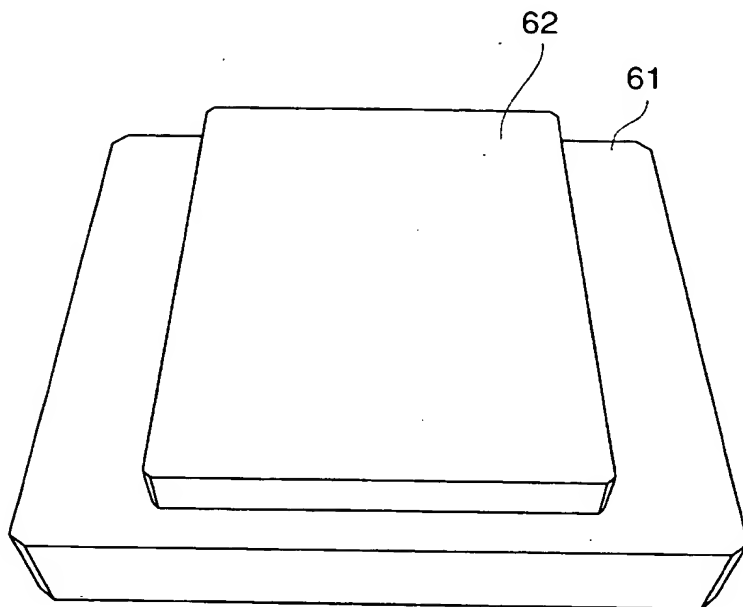


Fig. 20

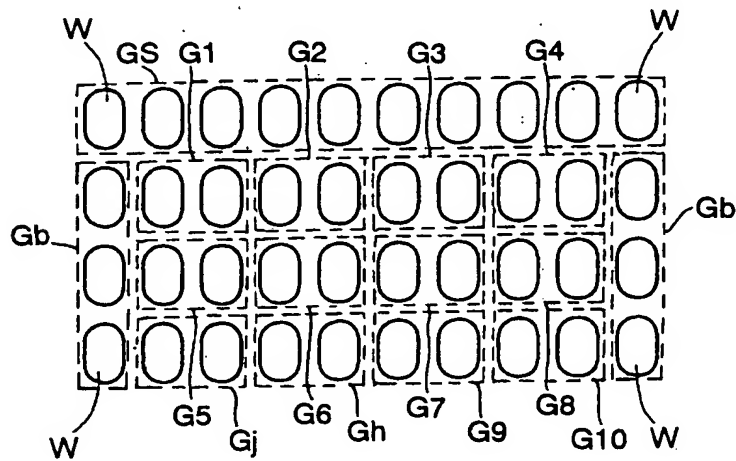


Fig. 21

Specimen No.	Net Fluorescent Intensity [CNT/mm <sup>2</sup> ]	Calibration Curve Conversion Amount [U/mL]
1	36.5	30.5
2	42.9	35.8
3	13.2	N.D
4	43.1	36.0
5	36.2	30.2
6	73.0	60.9
7	20.9	N.D
8	81.1	67.8
9	31.2	26.1
10	57.0	47.6
HL60	239.7	200.1
Jurkat	627.1	523.7

Fig. 22

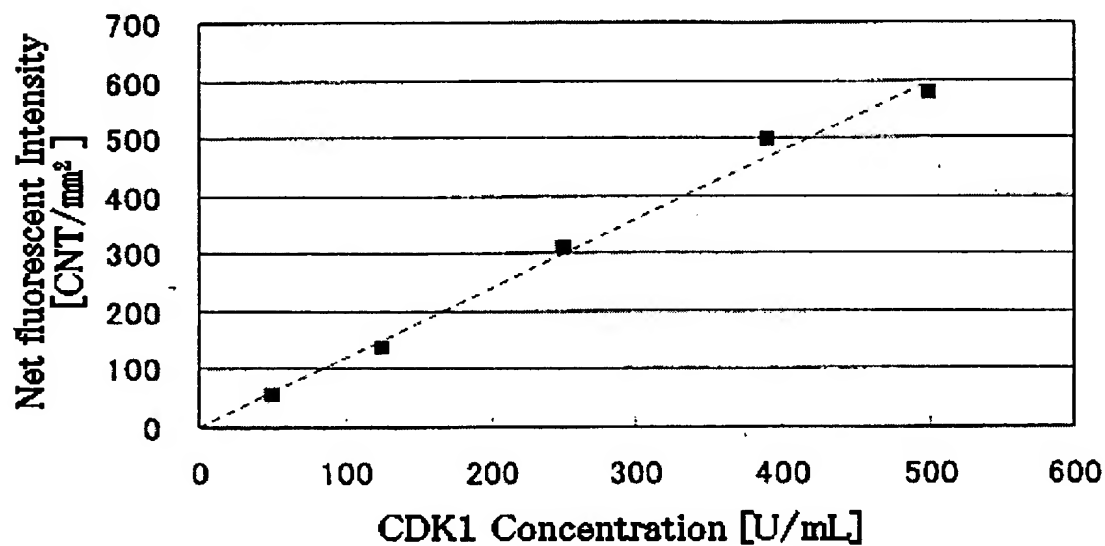


Fig. 23

